DOC MED

AO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Secretaria de Estado da Saúde
Equipe de licitação SIGMA
Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas - CEP.: 76.820-408
Porto Velho – RO

At.: Sr. (a) Pregoeiro e Equipe de Apoio

REF: **Pregão Eletrônico/SRP:** 445/2020/SIGMA/SUPEL/RO
Processo Administrativo: 0049.352138/2019-53
Data de Abertura: 12/08/2020 as 10h00
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares sob sistema de consignação, com fornecimento de equipamento sob Sistema de Comodato, visando atender a demanda dos Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Artigos Médicos Hospitalares sob sistema de consignação, com fornecimento de equipamento sob Sistema de Comodato, visando atender a demanda dos Serviço de Hemodinâmica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses, pelo preço global de **802.944,00 (Oitocentos e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais)** nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

DOC MED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., com sede na Alameda Dos Maracatins, 992 – 8° andar – Conjuntos 81,82,83,84 e 9° andar – Conjuntos 91,92,93 e 94 – Indianópolis – São Paulo – SP – CEP. 04089-001, pessoa jurídica de direito privado, Fone/Fax.: (11) 3106-8729, E-mail.: cesar.augusto@crlicitar.com.br, inscrita no CNPJ sob o n. º 66.877.184/0001-80, Inscrição Estadual n.º 113302970115, Inscrição Municipal n.º 2.009.011-0, por meio de seu procurador abaixo assinado, vem apresentar a sua proposta comercial, conforme segue:

Item	Especificações Mínimas	Qtd/ Unid	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
33	CATETER BALÃO NÃO COMPLACENTE	3936 Unid	MERIL LIFE SCIENCES/	**204,00** (Duzentos e quatro	**802.944,00** (Oitocentos e dois

	TROCA RÁPIDA (MONORAYL)		MERIL LIFE SCIENCES/ MOZEC NC	reais)	mil e novecentos e quarenta e quatro reais)

DESCRITIVO TÉCNICO SOLICITADO EM EDITAL E PLENAMENTE ATENDIDO PELO PRO7DUTO PROPOSTO: CATETER BALÃO NÃO COMPLACENTE TROCA RÁPIDA (MONORAYL) Cateter balão para angioplastia coronária de baixa complacência (para pósdilatação), de baixo perfil, sistema de troca rápida, resistente a altas pressões, com ponta afilada, duas marcas radiopacas e baixo perfil de cruzamento com diâmetros de 2mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,25 mm e 4,5 mm e nos comprimentos de 12mm, 15 mm e 20mm. O diâmetro e o comprimento serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação.

DESCRITIVO DO PRODUTO PROPOSTO: CATETER BALÃO NÃO COMPLACENTE CONFECCIONADO EM NYLON (NÃO COMPLACENTE), COM DUAS FAIXAS MARCADORAS RADIOPACAS DE PLATINUM/IRIDIUM NO INÍCIO E FINAL DO COMPRIMENTO DO BALÃO, COMPATÍVEL COM CATETER GUIA 5FR, RÁPIDA TROCA COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0.014. BALÃO CORONÁRIO NÃO COMPLACENTE – MOZEC NC.

MARCA/FABRICANTE: MERIL LIFE SCIENCES
MODELO: MOZEC NC
REGISTRO ANVISA: 10360810036
PROCEDÊNCIA: ÍNDIA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 802.944,00
(Oitocentos e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais**)**

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- **Prazo de entrega:** 30 dias após emissão da nota de empenho/assinatura do termo contratual, de acordo com as especificações descritas nos ANEXOS I, II
- **Local de entrega:** Central de Abastecimento farmacêutico – CAF II: Rua: Aparício de Morais nº. 4378 Bairro - Setor Industrial, - Telefone: (69) 3216–5759 - Porto Velho, Rondônia. O expediente é de segunda a sexta das 7:30 as 13:30 horas;
- **Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias, a partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993;
- **Garantia:** 12 (doze) meses contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos;

DOC MED

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

Cesar Augusto Rodrigues da Silva;

RG.: 25.982.467-7 SSP/SP / CPF n.º 224.093.448-44

Cargo: Procurador / Estado Civil: Casado / Profissão: Administrador de Empresas

Endereço Comercial: Rua Lord Cockrane, 616, Cj. 905/906 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04213-001

Tel.: (11) 99956-3552 / (11) 3106-8729 / E-mail.: cesar.augusto@crlicitar.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco (001) - Brasil

Agência: 4135-1

Conta Corrente: 12310-2

ANEXOS DA PROPOSTA:

- Registro do produto na Anvisa;
- Catálogo Técnico;

Atenciosamente,

São Paulo, 21 de agosto de 2020.

DOC MED COM. IMP. E EXP. LTDA
Cesar Augusto Rodrigues da Silva/
RG n.º 25.982.467-7 SSP/SP / CPF n.º 224.093.448-44
Procurador

MOZEC™ NC TECHNICAL SPECIFICATIONS

Catheter System	:	Rapid Exchange (Rx)
Balloon Material	:	Nylon - Non-Compliant
Available Balloon Lengths (mm)	:	8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38
Available Balloon Diameters (mm)	:	2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50
Usable Catheter Length	:	142 cm
Max Guidewire Compatibility	:	0.014" (0.36 mm)
Guide Catheter Compatibility	:	5F (min I.D. 0.056" / 1.42 mm)
Distal Shaft Coating	:	Biocompatible, Hydrophilic & Lubricious coating from distal balloon base upto rapid exchange port
Balloon RO Markers	:	2 - Platinum / Iridium
Tip Length	:	3.5±0.5 mm
Proximal Shaft Diameter	:	1.98 F
Distal Shaft Diameter	:	2.7 F
Markers on Proximal Shaft	:	Brachial and Femoral markers 90 cm and 100 cm from distal tip
Nominal Pressure (NP)	:	12 atm for all Diameters
Rated Burst Pressure (RBP)	:	20 atm for all Diameters

MOZEC™ NC ORDERING INFORMATION

Dia / Length	8mm	10mm	13mm	15mm	18mm
2.00mm	MNC20008	MNC20010	MNC20013	MNC20015	MNC20018
2.25mm	MNC22508	MNC22510	MNC22513	MNC22515	MNC22518
2.50mm	MNC25008	MNC25010	MNC25013	MNC25015	MNC25018
2.75mm	MNC27508	MNC27510	MNC27513	MNC27515	MNC27518
3.00mm	MNC30008	MNC30010	MNC30013	MNC30015	MNC30018
3.50mm	MNC35008	MNC35010	MNC35013	MNC35015	MNC35018
4.00mm	MNC40008	MNC40010	MNC40013	MNC40015	MNC40018
4.50mm	MNC45008	MNC45010	MNC45013	MNC45015	MNC45018

Dia / Length	23mm	28mm	30mm	35mm	38mm
2.00mm	MNC20023	MNC20028	MNC20030	MNC20035	MNC20038
2.25mm	MNC22523	MNC22528	MNC22530	MNC22535	MNC22538
2.50mm	MNC25023	MNC25028	MNC25030	MNC25035	MNC25038
2.75mm	MNC27523	MNC27528	MNC27530	MNC27535	MNC27538
3.00mm	MNC30023	MNC30028	MNC30030	MNC30035	MNC30038
3.50mm	MNC35023	MNC35028	MNC35030	MNC35035	MNC35038
4.00mm	MNC40023	MNC40028	MNC40030	MNC40035	MNC40038
4.50mm	MNC45023	MNC45028	MNC45030	MNC45035	MNC45038

CAUTION:
This product is intended for use by or under the direction of a Physician. Prior to use, it is important to read the package insert supplied with this device, thoroughly for Instructions for Use, Warnings and Potential Complications associated with use of this device. Tests performed by and data on file at Meril Life Sciences Pvt. Ltd. All drawings are artists representations only and not to be considered as an engineering drawing or photographs. Information for the use only in countries with applicable health authority product registrations.

Meril

Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Survey No. 135/139, Bilakhia House,
Muktanand Marg, Chala,
Vapi 396 191.
Gujarat. India.
T +91 260 305 2100
F +91 260 305 2125

Meril, Inc.
116, Village Boulevard, Suite 200,
Princeton, NJ 08540. USA.
T +1 609 951 2287
F +1 609 520 1702

Meril South America
Doc Med LTDA
Al. dos Tupiniquins,
1079 - Cep: 04077-003 - Moema.
Sao Paulo. Brazil.
T +55 11 3624 5935
F +55 11 3624 5936

Meril GmbH.
Bornheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn.
Germany.
T +49 228 7100 4000
F +49 228 7100 4001

Meril Tibbi Cihazlar Imalat Ve Ticaret A. S.
6, Mimar sinan Mah.,
Çavusbasi Cad. Özde Sok.
Aydin Eksi Is Merkezi Kat:1
Cekmekoy/Istanbul, Turkey.
T +90 53 2272 5172

E askinfo@merillife.com
W www.merillife.com

Mozec™NC is registered trademark of Meril Life Sciences Pvt. Ltd.

MNC/BROCHURE/003/MLS/20160902/IND

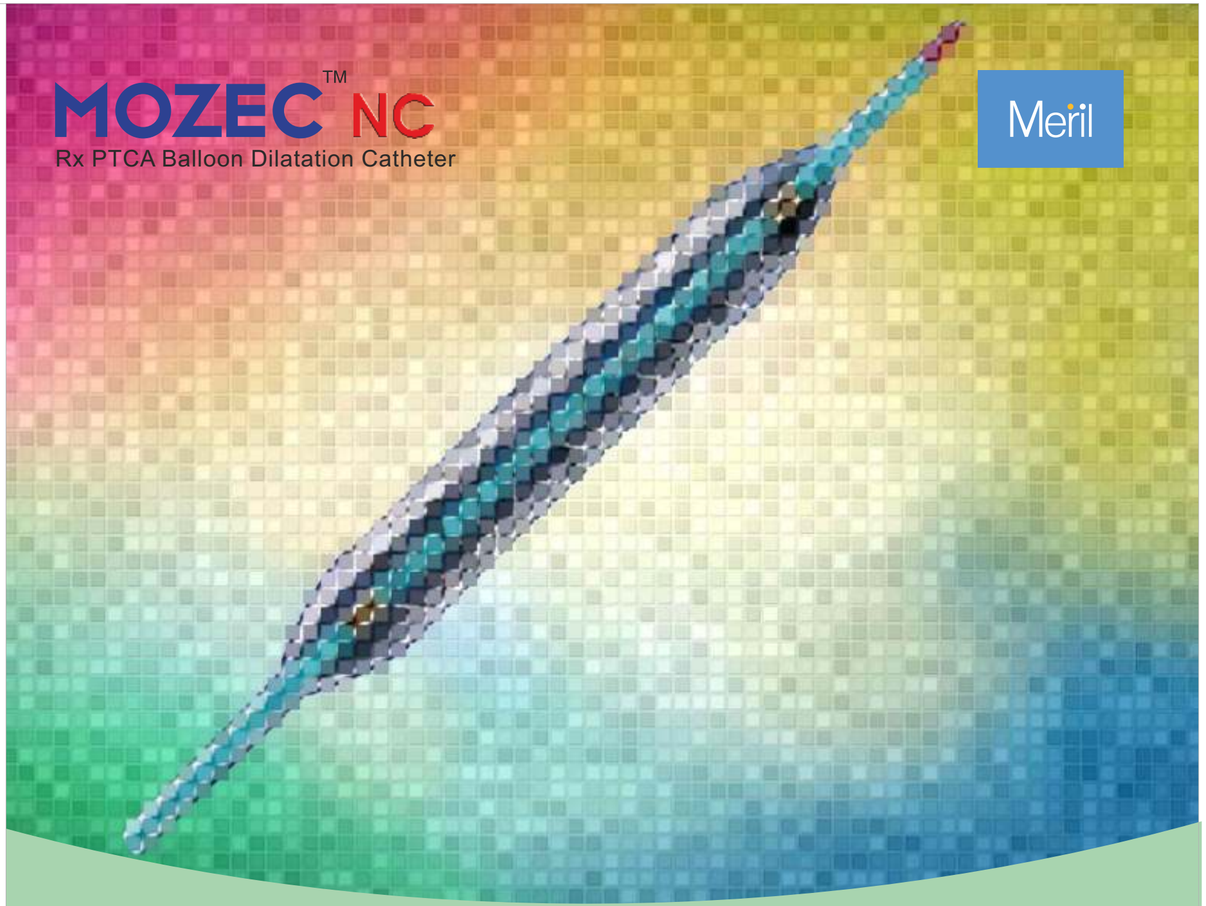

MOZEC™ NC

Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter

MOZEC™ NC

Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter

Handicraft for *Angio*craft.

Experience controlled and confident expansion with MOZEC™NC

Soft tip made up of medical grade PEBAX to facilitate advancement of the catheter to and through the stenosis

Low tip entry profile for easy cross and re-cross

Hump free fusion of distal tip inner tubing and balloon

Biocompatible, hydrophilic, lubricious coating from distal balloon base upto rapid exchange port

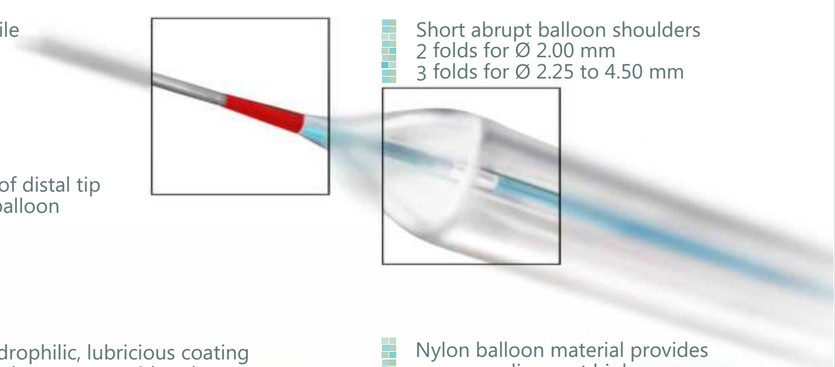

Short abrupt balloon shoulders
2 folds for Ø 2.00 mm
3 folds for Ø 2.25 to 4.50 mm

Nylon balloon material provides non-compliance at high pressure

Controlled balloon growth for flat compliance at high pressure

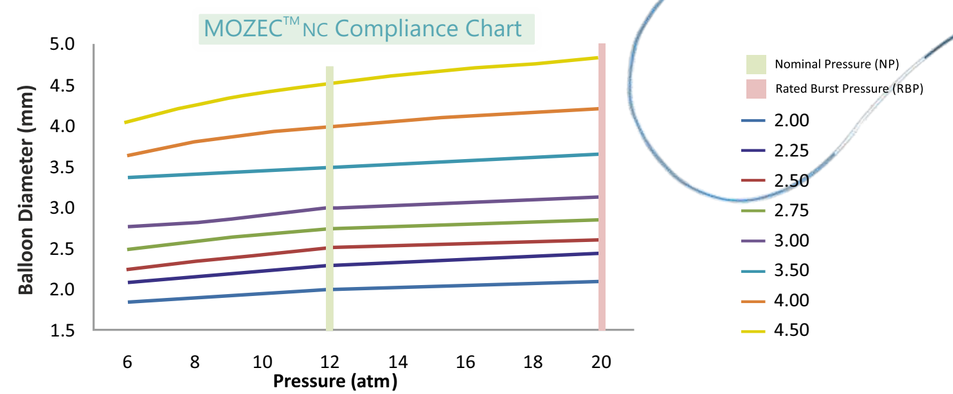

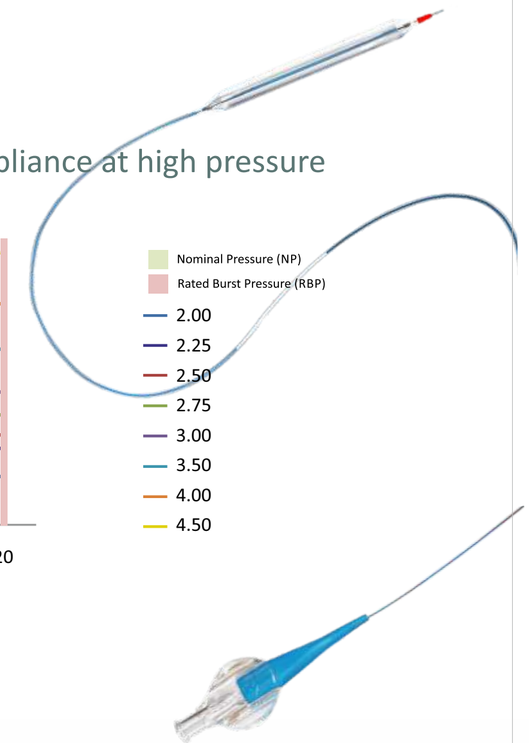

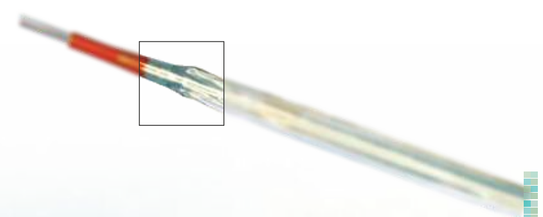

Low crossing profile and highly flexible **MOZEC™NC** is designed to acquire maximum pressure and meet clinical needs

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
CNPJ	66.877.184/0001-80	**Autorização**	1.03.608-1
Produto	CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PARA PTCA RX - MOZEC NC		

Modelo Produto Médico

MNC20008; MNC20010; MNC20013; MNC20015; MNC20018; MNC20023; MNC20028; MNC20030; MNC22508; MNC22510; MNC22513; MNC22515; MNC22518; MNC22523; MNC22528; MNC22530; MNC25008; MNC25010; MNC25013; MNC25015; MNC25018; MNC25023; MNC25028; MNC25030; MNC27508; MNC27510; MNC27513; MNC27515; MNC27518; MNC27523; MNC27528; MNC27530; MNC30008; MNC30010; MNC30013; MNC30015; MNC30018; MNC30023; MNC30028; MNC30030; MNC35008; MNC35010; MNC35013; MNC35015; MNC35018; MNC35023; MNC35028; MNC35030; MNC40008; MNC40010; MNC40013; MNC40015; MNC40018; MNC40023; MNC40028; MNC40030. Esterilizado por óxido de etileno.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA
Registro	10360810036
Processo	25351.226208/2018-35
Fabricante Legal	• FABRICANTE: MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD - ÍNDIA
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	10/08/2025

Voltar