COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ nº. 04.054.617/0001-40 – Insc. Estadual: nº 00000000868442
Insc. Municipal: nº 5832, Rua Padre Moretti, 3076, Liberdade – Porto Velho/RO – CEP: 76.803-854, Fone-Fax: (69) - 3223-1735/3223-5602
E-mail: bruna@realdiagnostica.com.br; christiane@realdiagnostica.com.br; licita.realdiagnostica@gmail.com

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 730/2020/SIGMA/SUPEL/RO
PROCESSO Nº 0062.316538/2020-61.

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme edital, que integra o instrumento convocatório do pregão em epígrafe.

DADOS DO PROPONENTE:
REAL DIAGNÓSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ nº. 04.054.617/0001-40 – Insc. Estadual: nº 00000000868442
Identificação do responsável legal da empresa: Christiane Mª. Simoni Sanches
CPF: 786.874.039-68 RG:5.795.793-0 SSP/PR
Rua Padre Moretti, 3076 – Bairro: Liberdade - Porto Velho/RO
Fone/Fax:69 3223-5602 Endereços de e-mail para contato: christiane@realdiagnostica.com.br bruna@realdiagnostica.com.br / licitacao@realdiagnostica.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A. AG.: 0102-3 C/C nº 130668-5

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento de Sistemas de Automação Laboratorial (equipamentos) tipo "Point of Care (POC)", todos os materiais de consumo e acessórios necessários à realização de procedimentos "ao pé do leito" para atender as necessidades da Rede Hospitalar estadual da Secretaria Estadual de Saúde – SESAU/RO, de forma continuada, por um período de 12 (doze) meses.

LOTE I - AUTOMAÇÃO - MARCADORES CARDIACOS (POINT OF CARE – POC)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. ANUAL	MARCA / MODELO	REGISTRO NA ANVISA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
LOTE I							
1	TROPONINA T	Serviço de fornecimento de equipamento s e insumos para realização de testes	8.100	ROCHE/COBASH232	10287410428	48,39	391.959,00
2	D- DIMERO		4.500	ROCHE/COBASH232	10287410066	49,39	222.255,00
3	MIOGLOBINA		600	ROCHE/COBASH232	10287410440	61,84	37.104,00
4	PRO-BNP		1.500	ROCHE/COBASH232	10287410545	59,31	88.965,00
						TOTAL R$	**740.283,00**

Equipamento ofertado: COBAS H232 – MARCA: Roche – Reg. Anvisa: 10287410670 – Procedência: Alemanha.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 740.283,00 (Setecentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e três reais).

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ nº. 04.054.617/0001-40 – Insc. Estadual: nº 00000000868442
Insc. Municipal: nº 5832, Rua Padre Moretti, 3076, Liberdade – Porto Velho/RO – CEP: 76.803-854, Fone-Fax: (69) - 3223-1735/3223-5602
E-mail: bruna@realdiagnostica.com.br; christiane@realdiagnostica.com.br; licita.realdiagnostica@gmail.com

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

LOCAL / FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS E INSUMOS/PRAZO:

Laboratório do Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Av. Campos Sales, 4295 - Nova Floresta, Porto Velho - RO;
Laboratório do Hospital CEMETRON, Av. Guaporé, 415 - Lagoa, Porto Velho - RO;

Os materiais (kits, reagentes, insumos e consumíveis) deverão ser entregues CONFORME SOLICITAÇÃO Exclusivamente no: Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC - Av. Jorge Teixeira, 3862 - Setor Industrial - CEP: 76.821-096 - Porto Velho/RO -Fone: (69) 3216-2218, de Segunda a Sexta-Feira das 7h30min às 12h30min.

O prazo para início dos serviços será de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato, publicação e emissão da ordem de serviço.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. **Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Porto Velho/RO, 11 de Janeiro de 2021.

Real Diagnostica Comercio de Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda
Christiane M. S. Sanches
Gerente de Licitações

04.054.617/0001 - 40
REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
RUA. PADRE MORETTI Nº 3076
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 76.803 - 854
PORTO VELHO - RO

Christiane Mª. S. Sanches
RG: 57957930 SSP/PR
CPF: 786.874.039-68
Gerente de Licitações

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA		
CNPJ	30.280.358/0001-86	**Autorização**	1.02.874-1
Produto	CARDIAC T QUANTITATIVE		

Apresentação/Modelo
10 tiras teste

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	TROPONINA
Registro	10287410428
Processo	25351.252323/2004-60
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICA GMBH - ALEMANHA
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	05/04/2025

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA		
CNPJ	30.280.358/0001-86	**Autorização**	1.02.874-1
Produto	CARDIAC D DIMERO		

Apresentação/Modelo
Kit para 10 determinações - 10 fitas testes

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	D-DÍMERO
Registro	10287410066
Processo	25351.011348/2003-24
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS - ALEMANHA
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	02/07/2023

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA		
CNPJ	30.280.358/0001-86	**Autorização**	1.02.874-1
Produto	CARDIAC M		

Apresentação/Modelo
20 tiras teste

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	MIOGLOBINA
Registro	10287410440
Processo	25351.002870/2005-87
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Classificação de Risco	II - Produtos que apresentam médio risco ao usuário ou ao paciente e baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA		
CNPJ	30.280.358/0001-86	**Autorização**	1.02.874-1
Produto	CARDIAC PROBNP		

Apresentação/Modelo
10 TIRAS TESTE DESCARTÁVEIS EM BOLSAS SELADAS

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	PEPTÍDEO NATRIURÉTICO CEREBRAL HUMANO (BNP)
Registro	10287410545
Processo	25351.342748/2005-41
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA		
CNPJ	30.280.358/0001-86	**Autorização**	1.02.874-1
Produto	COBAS h232		

Modelo Produto Médico
COBAS h232

Tipo de Arquivo	**Arquivos**	**Expediente, data e hora de inclusão**
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Instrumento para hemostasia
Registro	10287410670
Processo	25351.282108/2007-36
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

cobas h 232
Marcadores Cardíacos Point of Care
Segurança e Rapidez na Emergência

Conectividade por wireless (WI-FI):[1]

- Resultados podem ser compartilhados via Wi-Fi ou código QR e transferidos para o LIS/HIS e para o prontuário do paciente
- A conectividade permite a gestão remota do processo e a rastreabilidade dos resultados

WI-FI

Transferência de dados.

Transmissão automática de resultados do pronto-socorro, UTI para o LIS/HIS.

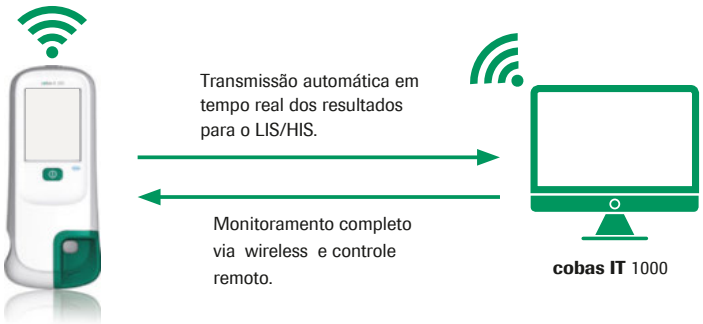

LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS POR QR CODE

Importa resultados diretamente do **cobas h** 232.

CÓDIGO QR VIA APP DO SMARTPHONE

Transferência de resultados móveis para o sistema de TI **cobas IT** 1000:

Ex.: da ambulância - garante tratamento rápido e adequado.

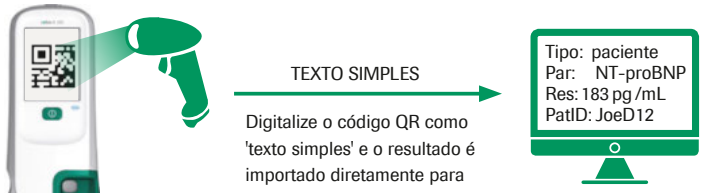

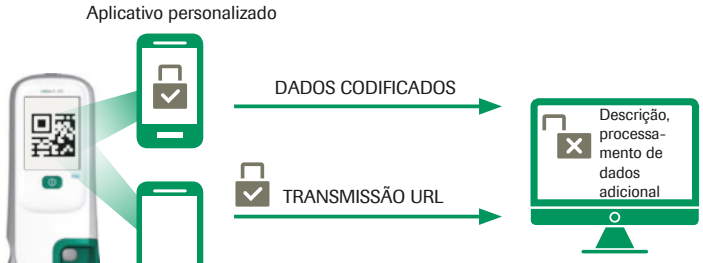

Digitalize o código QR em um aplicativo de smartphone ou tablet com a câmera embutida e compartilhe os resultados com a equipe multidisciplinar.

cobas h 232
Marcadores Cardíacos Point of Care
Segurança e Rapidez na Emergência

Testes e Controles de Qualidade

Parâmetro	Teste	Unidades suportadas
Troponina T	Roche CARDIAC POC Troponina T *REF 07007302190*	ng /L, pg / mL, ng / mL, µg /L
NT-proBNP	Roche CARDIAC proBNP + *REF 05533643190*	pg/mL
D-dímero	Roche CARDIAC D-Dímero *REF 04877802190*	µg /mL, ng /mL, mg /L, µg /L
Mioglobina	Roche CARDIAC M *REF 04877799190*	ng/mL
CK-MB	Roche CARDIAC CK-MB *REF 04877900190*	ng/mL
Controles	Roche CARDIAC controle para todos os parâmetros acima Roche CARDIAC IQC para checagem de performance do sistema óptico do medidor	

Tipo de amostra

Tipo de amostra	Sangue venoso total heparinizado
Volume de amostra	150 µL

Condições de funcionamento

Faixa de temperatura	18 to 32 °C
Umidade relativa	10–85 % (sem condensação)
Altitude máxima	4300 m

Condições de armazenamento e transporte

Faixa de temperatura	–25 a 70 °C
Umidade relativa	10–85 % (sem condensação)

Dados técnicos

Tela	*Touchscreen* colorido
Memória	2000 resultados de testes de pacientes 500 resultados de testes QC 200 resultados de testes IQC 4000 entradas de lista de pacientes 5000 entradas na lista de operadores
Transferência de dados via	Código QR Wi-Fi USB (unidade de base portátil e computador são necessários)
Interface	Interface infrared, LED/IRED class 1
Suportado comunicação interfaces	IR-impressoras POCT1-A comunicação via estação de docking POCT1-A comunicação via Wi-Fi Código QR
Códigos de barras suportados	Código 128, Código 39, Código 93, EAN 13, Interleaved 2/5, Codabar, GS1 DataBar Limited, QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec
Adaptador de energia	Entrada: 100–240 V AC (± 10 %) / 50–60 Hz / 350–150 mA Saída: 12 V DC / 1.25 A
Pacote de bateria	Pacote de bateria universal (Ordem do material n°.: REF 06869904001) Tipicamente medição de 10 pacientes
Operação da bateria Novo: Modo *stand by* com fonte de energia externa	O medidor desliga depois que o temporizador de desligamento automático é decorrido (5 minutos padrão) ou pressionando o botão On / Off. Novo estado de energia 'stand by': O medidor muda automaticamente para o modo 'stand by' após 10 minutos de inatividade ou pressionando o botão On / Off
Tempo de inicialização	Menos de 20 segundos (para novo começo) e 1 segundo (do modo *stand by*)
Tempo de medição	8 à 12 minutos (depende do parâmetro do teste)
N° de testes com a bateria totalmente carregada	Aprox. 10 testes
Desligamento automático	Programável
Dimensões	244 x 105 x 51 mm
Peso	Aprox. 526 g incluindo pacote de bateria e scanner

CK-MB, Banda miocárdica de creatina-quinase; DMS, sistema de gerenciamento de dados; NT-proBNP: Peptídeo natriurético fragmentado N-terminal; POC, Point of Care.

Referências:

1 Roche (2016). cobas h 232 POC system Operator's Manual, Versão 6.0.

COBAS, COBAS H, ROCHE CARDIAC, IQC e LIFE NEEDS ANSWERS são marcas da Roche.
N° Registro ANVISA: 10287410670; 10287410428; 10287411111; 10287410909; 10287410066; 10287410440; 10287410750

©Roche - Janeiro/2018 - código: LRDL1150
Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729 – prédio 38 São Paulo, SP, 05321-010 – Brasil - 0800 77 20 295

cobas®

Life needs answers

cobas h 232

Resultados imediatos de marcadores cardíacos
Porque cada minuto conta!

Roche

Menu completo e rápido

Teste	Parâmetro	Tempo de reação	Intervalo de medição	Utilidade Clínica	Cut-off
Roche CARDIAC T Quantitative	Troponina T	12 minutos (resultado qualitativo em 8 minutos)	0,03 - 2 ng/mL	Diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)	< 0,03 ng/mL - baixo risco 0,03 - 0,1 ng/mL - risco médio > 0,1 ng/mL - alto risco
Roche CARDIAC CK-MB*	CK-MB*	12 minutos	1,0 - 40 ng/mL	Diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Reinfarto	Mulheres: 4 ng/mL Homens: 7 ng/mL
Roche CARDIAC M	Mioglobina	8 minutos	30 - 700 ng/mL	Marcador do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Reinfarto	70 ng/mL
Roche CARDIAC D-Dimer	Dímero-D	8 minutos	0,1 - 4,0 µg/mL	Exclusão da Trombose Venosa Profunda (TVP) e Embolia Pulmonar (EP)	0,5 µg/mL
Roche CARDIAC proBNP	NT-proBNP	12 minutos	60 - 3000 pg/mL	Diagnóstico e Prognóstico da Insuficiência Cardíaca (ICC)	< 300 pg/mL - Exclui ICC > 1800 pg/mL - Confirma ICC 300 - 1800 pg/mL - utilizar estratificação pela idade

** Lançamento previsto para 2º semestre de 2008.*

cobas h 232
Analisador de Marcadores Cardíacos

Desenvolvido para proporcionar confiabilidade, rapidez e agilidade na prática clínica

- Fácil manuseio
- Perfeito para uso na emergência e no consultório
- Leitor de código de barras opcional
- Calibração automática através de chip código (o chip código acompanha cada caixa de tiras)
- Menu completo.
  - Troponina T
  - CK-MB
  - NT-proBNP
  - Mioglobina
  - Dímero-D

Colocar tira teste

Aplicar a amostra (150 µL de sangue venoso heparinizado)

Resultado em poucos minutos

Na Emergência Cardíaca é necessário resultados rápidos e decisões imediatas

cobas h 232 no seu consultório:

- Reduz tempo de espera
- Otimiza recursos
- Evita retornos constantes

cobas h 232 na emergência:

Diagnóstico preciso em 15 minutos

▼

Direcionamento rápido do paciente

▼ Melhores resultados

▼ Melhor resposta ao tratamento

▼ Melhor acompanhamento do paciente

Diagnóstico rápido na prática clínica

- Confiabilidade: resultados rápidos correlacionados com o método laboratorial Roche
- Praticidade: equipamento livre de manutenção e com calibração automática
- Flexibilidade: utilização na emergência e ambulatório

OUTUBRO 2010

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP, 05321-010, Brasil
0800 77 20 295

Código	Descrição	Número de Registro
4901126190	cobas h 232	10287410670
4877845190	cobas h 232 PRO BNP	10287410545
4877772190	cobas h 232 TROPONINA T	10287410428
4877802190	cobas h 232 DIMERO-D	10287410066
4878949001	cobas h 232 MIOGLOBINA	10287410440
4880668190	cobas h 232 IQC	10287410556

Roche